


Termék	Leírás	Rend.sz:
testo 350 kezelőegység	Opcionális: Bluetooth® (csak az analizátorban lévő Bluetooth® egységgel működik)	0632 3511
testo 350 analizátor	O ₂ mérőcella, 0 ... 25 % CO mérőcella (H ₂ kompenzált), 0 ... 10.000 ppm, felbontás 1 ppm NO mérőcella, 0 ... 4000 ppm, felbontás 1 ppm* NO ₂ mérőcella, 0 ... 500 ppm, felbontás 0,1 ppm Peltier gázelőkészítő a tömlőszivattyúban Frisslevegő szelep a hosszú időtartamú mérésekhez Bluetooth® (csatlakozás a kezelőegységhez, laptophoz vagy nyomtatóhoz a megfelelő Bluetooth® felszereléssel) Opció: méréstartomány bővítés egy cellán Opció: SO ₂ , 0 ... 5000 ppm, felbontás 1ppm	0632 3510
Szondák	Moduláris füstgázszonda, 335 mm, rögzítőkónusz, NiCr-Ni hőelem Tmax +1000°C, NO ₂ /SO ₂ speciális tömlő 2,2m	0600 8764
	Opcionális: moduláris füstgázszonda 700 mm	0600 8765
	Tömlő hosszabbító 2,8m; a szonda akár 5-ször toldható (16,2 m) Használható nagy ipari égőkön (méréspontra és megfigyelő pontra)	0554 1202
Tartozékok	testo Bluetooth®-/IRDA nyomtató, 1 tekercs hőpapír, újratölthető akkumulátor, hálózati adapter	0554 0620
testo easyEmission szoftver	Szoftver USB kapcsolattal a PC-hez való csatlakozáshoz Funkciók: felhasználó által definiált mérési időközök, mért értékek továbbítása Microsoft Excel táblázatba másodpercek alatt, felhasználó által definiált tüzelőanyagok, értékek kijelzése táblázatban vagy grafikus formátumban, felhasználó-specifikus mérésprotokollok egyszerű beállítása	0554 3334
Műszerbőrönd	Műszerbőrönd a testo 350 füstgázvizsgáló rendszer, a szondák, és további tartozékok kényelmes és biztonságos szállításához, méretek: 570 x 470 x 210 mm	

* Az alacsony NO értékek méréséhez az NO_{alacsony} mérőcellát ajánljuk (0393 1152).



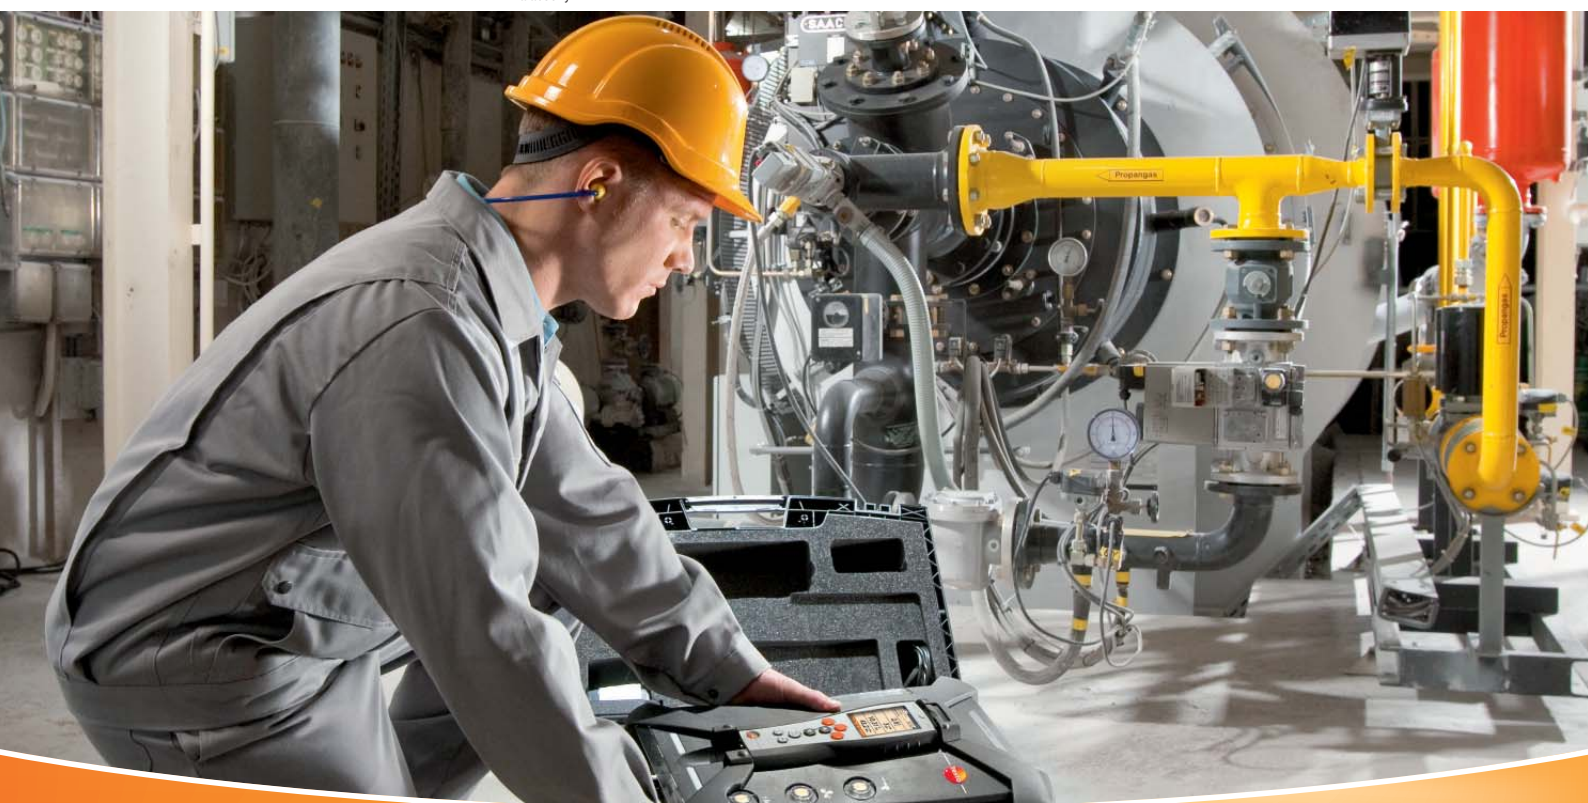

**testo 350 - kezelőegység
a füstgázelemző rendszerhez**

– 0632 3511

- Égő-specifikus beállítások



**testo 350 - analízátor a
füstgázelemző rendszerhez –**
0632 3510

Peltier gázlökészítő

- Füstgáz hűtése a száraz mérésekhez
- Kifejezetten alkalmas a 2 óránál hosszabb mérésekre

Mérőcellák

- **O₂** a füstgáz O₂ koncentrációjának meghatározásához, valamint tömegkoncentráció számításához [mg/m³]
- **CO** a katalizátor ellenőrzésére (ha van a rendszerben) és tömegkoncentráció számításához [mg/m³]
- **NO+NO₂** NO₂ számításához a növekedési tényező alapján; pontos NO és NO₂ mérések az NO_x határértékek betartásához.
Tömegkoncentráció számítás [mg/m³]
- Opcionális: **SO₂**
(Tömegkoncentráció számítás [mg/m³])

Frisslevegő szelep

- Hosszú időtartamú mérésekhez és automatikus mérésprogramokhoz
- Méréstartomány bővítés 5 faktoral minden mérőcellára

Méréstartomány bővítés egy foglalon

- Hígítási faktorkok: 2x, 5x, 10x, 20x, 40x (pl. CO 400.000 ppm-ig 40x-es hígítással)



testo easyEmission szoftver

– 0554 3334

- Adatszerzés és mérésprotokollok készítése



Moduláris füstgázszonda

– 0600 8764

- Gyors szondacsere különböző méretű füstgázvezető csövekhez

Opcionálisan elérhető:
Füstgázszonda előszűrővel
– 0600 8766



Csak akkor működik, ha a kezelőegység és az analízátor is rendelkezik telepített Bluetooth kapcsolattal

*Hivatalos emisszió mérések (országfüggő)